


## Test Modul PE50R

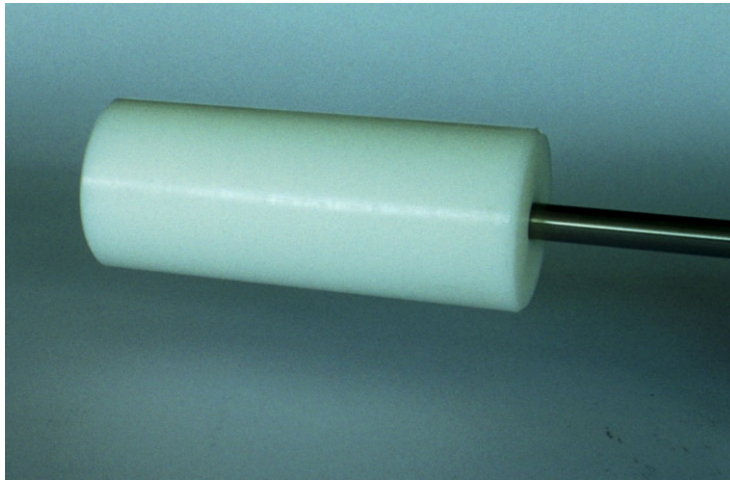

Das Testmodul PE50R dient zur Überprüfung, Kalibrierung unserer kapazitiven Feuchtigkeitsmessgeräten DS5-AL und PD5-AL.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Sensor prüfen, er muss sauber und trocken sein!

Angegebene Materialeinstellung wählen,

Sensor in die Luft halten einschalten, der Nullpunkt wird automatisch korrigiert. Das Gerät dabei nur am unteren Gehäuseende anfassen.

OK-Taste drücken, Sensor wie abgebildet in das Testmodul stecken, der angezeigte Messwert muss in dem angegebenen Sollwertbereich liegen.

Messgerät Typ	Einstellung	Sollwert	Kommentar:
DS5-AL	Material 1	9,2±0,5	
PD5-AL	P1	9,2±0,5	